

Warszawa, 02.04.2024

Do: Wszystkich Zainteresowanych

OŚWIADCZENIE

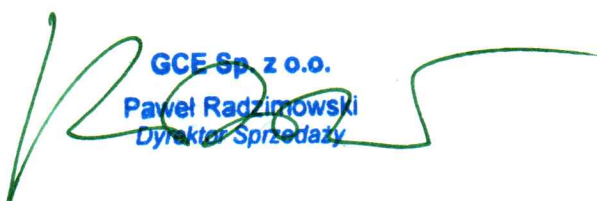
Niniejszym firma GCE, jako producent reduktorów Mediselect II i Medireg II oświadcza, że zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej w/w reduktorów nie wymaga się przeprowadzania przeglądów konserwacyjno/serwisowych w okresie żywotności reduktorów opisanych w instrukcji obsługi.

Dla w/w reduktorów okres żywotności wynosi 10 lat.

Wskazana jest jedynie kontrola wzrokowa dokonana przez użytkownika każdorazowo po zmianie butli, lub raz na 2 lata, obejmująca stwierdzenie braku widocznych uszkodzeń i zanieczyszczeń.

Dokładny opis kontroli znajduje się w instrukcji obsługi reduktorów, dołączonej do produktu.

Z poważaniem


GCE Sp. z o.o.
Paweł Radziński
Dyrektor Sprzedaży